



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 313
DEL 03 MAG 2016

OGGETTO: Progetto 186. Indizione gara aperta sottosoglia per l'acquisizione in service di un sistema analitico automatizzato per la determinazione di HR-HPV-DNA per il Laboratorio di Citologia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

U.O. PROPONENTE : PROVVEDITORATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 31
DEL 05 APR 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Francesca La Paglia
Francesca La Paglia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROPONENTE
Dr. Libera F. Carta
Libera F. Carta

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. del C.E. C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mariano F. ...

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
DIRETTORE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr.ssa O. Monasteri
O. Monasteri

NUMERO PROTOCOLLO DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF 65872
DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF _____

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO / IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DISTRETTO TERRITORIALE /IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DISTRETTO
OSPEDALIERO /IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

PREMESSO:

Che con nota prot. n.8 del 12/01/2016 il Direttore dell'UOC Materno Infantile Territoriale ha chiesto l'acquisizione, in service, di un sistema analitico automatizzato per la determinazione di HR-HPV DNA in prelievi cervico-vaginali, in attuazione del P.O. 2013 PSN- linea progettuale 13,2. Progetto 186 la cui disponibilità ammonta a €.15.000;

Che la procedura di acquisizione è stata avviata dal Servizio Provveditorato in data 03.02.2016 e si è conclusa con esito negativo in quanto il sistema offerto dall'unica ditta partecipante non è stato giudicato conforme ai requisiti prescritti nel capitolato di gara, come si evince dal parere tecnico del 10.03.2016 prot. n. 182/CIT formulato dal Sanitario utilizzatore di cui si allega copia;

Che il Sanitario utilizzatore con nota prot. n.183 del 10.03.2016 nel riproporre l'avvio di un secondo esperimento di gara suggerisce di aumentare il costo per singolo test e di prevedere una durata massima di tre anni a condizione che vengano confermati gli stanziamenti dedicati da parte dell'Assessorato Sanità che provvede annualmente all'assegnazione dei fondi;

CONSIDERATO:

Che risulta vantaggioso per l'Azienda esperire una gara della durata triennale, condizionata all'assegnazione del finanziamento regionale onde evitare il ricorso a procedure ripetitive che comportano dispendio in termini di tempo e di risorse;

Che preso atto che i beni non sono presenti in nessuna convenzione Consip né sul Mepa per cui occorre, sulla base dell'entità della spesa, della necessità ed urgenza di assicurare i beni per l'attuazione del progetto 186 "attivazione di percorsi di gruppi di donne difficili da raggiungere mediante l'offerta dell'HPV TEST in contemporanea alla pratica del pap test" esperire gara aziendale, in service, aperta a tutti i fornitori che abbiano i requisiti richiesti;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Nota prot. n.182/2016 Parere di non conformità
- B. Nota prot. n.183/2016
- C. Lettera d'invito
- D. Capitolato Tecnico


Assumendo la responsabilità, veridicità e legittimità della presente proposta e della sua correttezza formale e sostanziale

PROPONE

1. Di indire procedura di gara aperta sottosoglia per l'acquisizione in service di un sistema analitico automatizzato per la determinazione di HR-HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali per il Laboratorio di Citologia presso il P.O. Chiello di Piazza Armerina.
2. Di approvare la lettera d'invito, il capitolato tecnico e l'avviso di gara.
3. Di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito web aziendale sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.A. n.01283 del 03/07/2013 e sul sito ministeriale "Contratti Pubblici"
4. Aggiudicare la fornitura alla ditta che, per l'intero lotto, avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, anche in presenza di una sola offerta (art. 69 R.D. n. 827/24).
5. Dare atto che, avendo il presente atto natura propedeutica, il costo relativo all'anno 2016 di €. 15.000,00 Iva inclusa graverà sui fondi di cui al Progetto n 186" mentre per gli anni successivi graverà sui rispettivi progetti.
6. Dare immediata esecutività al presente atto al fine di definire la procedura in tempi brevi e assicurare la realizzazione del progetto.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Provveditorato-Economato

Dr. Libera F. Carta



L'anno duemilasedici il giorno *tre*..... del mese di *Marzo*..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Giovanna Fidelio nominato con D.P. n.08/Serv.1/S.G. del 19/01/2015
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Maurizio Lanza e dal Direttore Sanitario,
Dott. Emanuele Cassarà e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante

VISTI

- ✓ La superiore proposta;
- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato con delibera n.2556 del 23/09/2010;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato con delibera n. 2448/2011;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo


DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto, facendola propria e pertanto:
2. Di indire procedura di gara aperta sottosoglia per l'acquisizione in service di un sistema analitico automatizzato per la determinazione di HR-HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali per il Laboratorio di Citologia presso il P.O. Chiello di Piazza Armerina.
3. Di approvare la lettera d'invito, il capitolato tecnico e l'avviso di gara.
4. Di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito web aziendale e sul sito dell'Assessorato Regionale della Salute, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.A. n.01283 del 03/07/2013 e sul sito ministeriale "Contratti Pubblici".
5. Aggiudicare la fornitura alla ditta che, per l'intero lotto, avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato, anche in presenza di una sola offerta (art. 69 R.D. n. 827/24).
6. Dare atto che, avendo il presente atto natura propedeutica, il costo per l'anno 2016 di €.15.000,00 Iva inclusa graverà sui fondi di cui al Progetto n 186" mentre per gli anni successivi graverà sui rispettivi progetti.
7. Dare immediata esecutività al presente atto al fine di definire la procedura in tempi brevi e assicurare la realizzazione del progetto.


IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Casarà



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Maurizio Lanza

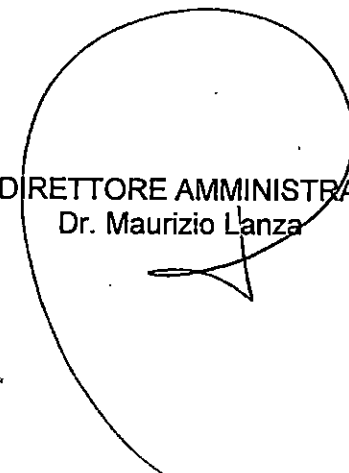


IL DIRETTORE GENERALE
- D.ssa Giovanna Fidele -



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

L'Assistente Amministrativo
Giuseppa Tornabene



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal _____ al _____

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente Amm/vo U.O.C. COORD. STAFF
(Dr.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 03 MAG. 2016

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
ASSISTENZA MATERNO INFANTILE TERRITORIALE



Prot. n. 8

Enna, li 1 GEN 2013

Al Servizio Provveditorato U.O. Appalti e Forniture

SETTORE PROVVEDITORATO
SERVIZIO APPALTI E FORNITURE

SEDE

PROVVEDITORE *MS*
DEL 15 GEN 2013
ASSEGNIATO AL *CAPAGLIA*

OGGETTO: Acquisizione strumentazione e materiali per Linea progettuale 13.2 – PSN2013

In attuazione del P.O. 2013 PSN, linea progettuale 13.2 – ATTIVAZIONE DI PERCORSI PER GRUPPI DI DONNE DIFFICILI DA RAGGIUNGERE MEDIANTE L'OFFERTA DELL'HPV TEST IN CONTEMPORANEA ALLA PRATICA DEL PAP TEST - e secondo le direttive dell'Assessorato Regionale della Salute, nelle more dell'adozione definitiva dell'HPV-DNA test come test primario di screening, occorre avviare l'esecuzione dell'HPV-DNA test, in contemporanea alla pratica del pap-test, su gruppi di donne difficili da raggiungere della fascia target 35-64 anni.

Ciò consentirà di fare una prima analisi dei dati epidemiologici relativi alle patologie riconducibili all'HPV nonché di effettuare un confronto con i dati dei Pap-test che saranno effettuati in contemporanea.

Per quanto sopra, si richiede l'acquisizione di un "Sistema completo analitico automatizzato per la determinazione di hr-HPV DNA in prelievi cervico-vaginali raccolti in soluzione liquida di trasporto". Il costo è a carico del "Fondo PSN 2013 – linea 13.2" – Progetto 186 (disponibilità 15.000 euro).

In allegato le caratteristiche tecniche.

Il Direttore UOC Materno-Infantile territoriale

Dott.ssa Loredana Disimone

SISTEMA COMPLETO ANALITICO AUTOMATIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DI HR HPV DNA IN PRELIEVI CERVICO VAGINALI RACCOLTI IN SOLUZIONE LIQUIDA DI TRASPORTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Si richiede un sistema analitico ad alto grado di automazione delle varie fasi del processo (preparazione dei campioni, analisi, elaborazione dei risultati, etc), costituito da strumentazione, tests e quant'altro necessario, per la ricerca di HR-HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali in fase liquida, validato e standardizzato per l'identificazione di lesioni cervicali di alto grado (CIN2+), secondo le linee guida di Meijer (Meijer et al. Int J Cancer, 2009) e come raccomandato dall'Health Technology Assessment Report: «Ricerca del DNA del Papillomavirus umano HPV come test primario per lo screening dei precursori del cancro del collo uterino», *Epidemiologia & Prevenzione* 2012; 36 (3-4) Suppl. 1: e1-72).

Il sistema dovrà avere una sensibilità clinica per lesioni CIN2+ non inferiore al 90% rispetto al test Hybrid Capture 2 ed una specificità clinica per lesioni CIN2+ non inferiore al 98% rispetto al test Hybrid Capture 2.

Il sistema dovrà essere validato secondo le certificazioni CE IVD.

Il possesso delle caratteristiche sopradette dovrà essere dimostrato da studi scientifici, in screening per il cervicocarcinoma, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali;

Il test dovrà possedere una sensibilità clinica validata;

Il test offerto deve essere in grado di rilevare tutti i genotipi ad Alto Rischio dell'HPV indicati dallo IARC con una riproducibilità inter-laboratorio più alta possibile espressa in percentuale e documentabile;

Il risultato finale deve essere prodotto in modo automatico del tipo positivo/negativo;

Deve disporre di un sistema gestionale capace di elaborare, archiviare e memorizzare i risultati e che riesca a validare la seduta;

Devono essere forniti tutti i reagenti necessari, i controlli di qualità, i calibratori, materiale di consumo e qualsiasi altro tipo di materiale occorrente per l'esecuzione delle determinazioni richieste;

Dev'essere altresì fornito il sistema per il prelievo dei campioni cervicali ed il relativo trasporto;

Tutti i reagenti principali devono essere pronti all'uso, con minimo impatto del personale nella gestione dei reattivi;

Eventuali innovazioni tecnologiche ed applicative che si dovessero rendere disponibili durante la fornitura, dovranno essere offerte dalla Ditta

aggiudicataria senza ulteriori aggravii economici;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità nel tempo della fornitura di tutto quanto richiesto nel presente capitolato;

L'offerente deve prestare gratuitamente l'assistenza tecnica necessaria anche con eventuale sostituzione dell'apparecchiatura entro 15 gg e dovrà procedere, sempre gratuitamente, al trasporto ed installazione, collaudo e messa in operatività, manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali aggiornamenti e formazione per il personale preferibilmente in loco;

Tutti gli strumenti offerti devono essere nuovi, di ultima generazione, non ricondizionati, offerti in comodato d'uso gratuito, pertanto non sarà dovuto alcun canone per il noleggio;


La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'idoneo addestramento del personale;

La ditta aggiudicataria dovrà fornire N 1 frigo-congelatore a doppia porta con vano frigorifero di almeno L 100 per la conservazione di campioni e reagenti;

Deve essere indicato il numero di determinazioni necessarie per eventuali controlli e calibratori al fine di poter valutare il reale costo/test;

Tutte le apparecchiature devono essere dotate di idoneo gruppo di continuità anti black-out elettrico.

Test	Prezzo base d'asta
Da 900 a 1.200 annui	€. 22,00 per test oltre IVA

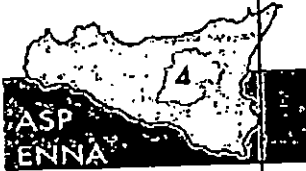

REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
 Cod. fisc./P.IVA 01151150867
www.ausl.enna.it/

DATA 10/03/2016

Laboratorio di Citologia
 P.-O. "M. Chiello"
 Piazza Armerina (EN)
 Tel. 0935-981.387 / 981.898
 Fax 0935-981.731

PROT. n. 182/Cit.

Al Sig. Direttore Servizio Provveditorato

e p. c. al Sig. Referente Screening del Cervico-carcinoma

Enna
 Enna

OGGETTO: parere tecnico di conformità per cottimo fiduciario per la fornitura in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico-vaginali.


Il sottoscritto dottor Bruno Morante, su richiesta di codesto Servizio Provveditorato, avendo preso visione dell'unica offerta pervenuta da parte della ditta Qiagen in merito alla gara per la fornitura di un sistema completo analitico automatizzato per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico-vaginali raccolti in soluzione liquida di trasporto esprime parere di non conformità sulle apparecchiature proposte rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara e precisamente al primo capoverso dove si richiedeva "...un sistema analitico ad alto grado di automazione delle varie fasi del processo (preparazione dei campioni, analisi, elaborazione dei risultati, etc)..."

La strumentazione proposta dalla ditta Qiagen, composta da Luminometro DML 300, agitatore Rotary Shacker I e incubatore Hybrid Capture System Microplate Heater I, corredati da personal computer può essere definito, in considerazione del notevole impegno manuale da parte dell'operatore nell'effettuare i vari passaggi, una strumentazione per metodica semi-automatica.

La richiesta di un sistema analitico "ad alto grado di automazione" per l'esecuzione dell'HPV-test è giustificata dalla carenza di personale tecnico da dedicare a tale procedura semi-automatica che richiede circa 6 ore e 30 minuti di impegno e attenzione costante, da parte dell'operatore, per poter portare a termine un ciclo analitico.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Morante

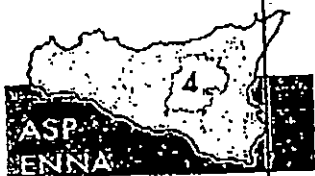

REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
 Cod. fisc./P.IVA 01151150867
www.ausl.enna.it/

DATA 10/03/2016

Laboratorio di Citologia
 P. O. "M. Chiello"
 Piazza Armerina (EN)
 Tel. 0935-981.387 / 981.898
 Fax 0935-981.731

PROT. n. 183/Cit.

Al Sig. Direttore Servizio Provveditorato

e p. c. al Sig. Referente Screening del Cervico-carcinoma
 Enna
 Enna


OGGETTO: suggerimenti per gara di affidamento di cottimo fiduciario per la fornitura in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico-vaginali.

Il sottoscritto dottor Bruno Morante, una volta valutata la non conformità al capitolato di gara per la fornitura in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico-vaginali da parte dell'unica offerta presentata da parte della ditta Qiagen, al fine di portare a termine l'affidamento del cottimo fiduciario di cui trattasi, secondo quelle che sono le esigenze aziendali, suggerisce, per la nuova indizione di tale gara, di

1. aumentare il costo per test offerto fino a 22,00 euro, prezzo che risulta, da indagine di mercato effettuata, più congruo al fine di ottenere un sistema analitico automatico.
2. Indicare la durata della gara in anni uno, informazione, questa, richiesta verbalmente allo scrivente da parte dei rappresentanti di tutte le ditte invitate.
3. Indicare la possibilità che la gara aggiudicata potrà essere prorogata di un anno alla volta fino ad un massimo di tre anni complessivamente, dipendendo tale prolungamento del service dallo stanziamento eventuale di ulteriori fondi dedicati.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Morante

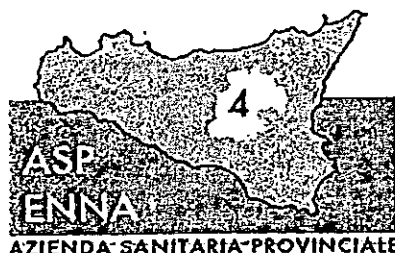

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520711
Fax 0935-520177

UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato
EMAIL:
provveditorato@aspenna.it
WEB:
<http://www.asp.enna.it/>

DATA

PROT.

/FL

Oggetto: Informazione avvio procedimento di gara

Procedura aperta sottosoglia per la fornitura in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico vaginali.

Con la presente si comunica che è in pubblicazione sul sito aziendale la documentazione per la partecipazione alla gara di cui in oggetto.

Le lettere d'invito/capitolati speciali d'appalto è resa pubblica e disponibile sul sito aziendale: www.asp.enna.it ed ha valore di formale invito alla partecipazione.

Si rappresenta che il concorso è aperto a tutte le ditte che ne abbiano interesse e che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è ore 10,00 del _____.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Libera F.Carta

U.O.C. Servizio Provveditorato: Viale Armando Diaz n° 7/9 - 94100 - Enna - tel. 0935 - 520131 - fax - 0935-520177-



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340-520345

Servizio: **Provveditorato**

Enna li,
Viale Diaz n° 7/9 - Cap. 94100 Enna

Protocollo

Oggetto: Richiesta preventivo per l'acquisto in service di un sistema completo analitico automatizzato per la determinazione di HR HPV DNA prelievi cervico vaginali raccolti in soluzione liquida di trasporto.

Spett.le Ditta

Si prega codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica - per l'acquisto in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA in prelievi cervico-vaginali come da capitolato tecnico allegato alla presente lettera d'invito.

Valore stimato €. 45.000 + Iva per una durata triennale **CIG**

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Il plico racchiudente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica deve essere sigillato con nastro adesivo che escluda ogni possibilità di manomissione, senza l'utilizzo di ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare la denominazione della Ditta e la dicitura: Offerta economica "...indicare l'oggetto della gara. " e il lotto per il quale si partecipa, dovrà contenere i seguenti documenti:

a) Busta documentazione amministrativa:

Nella busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi della L. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC, come da modello allegato;
- Patto d'integrità anticorruzione

b) Busta documentazione tecnica . Nella stessa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Referenze scientifiche relative all'utilizzo del sistema diagnostico dimostrato da studi scientifici, in screening per il cervicocarcinoma, pubblicati su riviste nazionali ed internazionali

Servizio Provveditorato - U.O.S. Economato - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520725 - 0935/520128 - fax 0935/520340 -520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 - 520345

- Scheda tecnica della strumentazione (dettagliata descrizione dell'apparecchiatura che si intende fornire con indicazione del produttore, distributore ed assistenza) completa delle caratteristiche di funzionamento e delle prestazioni ;
- Depliant illustrativo
- Dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in laboratori di analisi cliniche;
- Scheda reagenti che evidenzia le caratteristiche analitiche (tecnico scientifiche) di ciascun prodotto offerto;
- Nome del produttore;
- Quantità del prodotto necessario per ciascuna determinazione;
- Il tipo di confezione proposta e i relativi codici;
- Le condizioni ottimali di conservazione dei reattivi e dei campioni;
- Copia dell'offerta senza prezzi;
- garanzia + assistenza full risk, dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo contrattuale con l'obbligo di eliminazioni;
- disponibilità ad effettuare eventuale demo qualora richiesta dal Sanitario utilizzatore da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta presso l'U.O. di destinazione o una visita presso un Centro ove il sistema risulti operante già da tempo.

c) **Busta offerta economica**, sigillata con nastro adesivo e siglata dal rappresentante Legale dovrà essere inserita l'offerta economica dettagliata firmata dal Rappresentante Legale:

- Ragione sociale, codice fiscale partita Iva e sede legale della Ditta;
- Il codice CIG indicato nella presente lettera d'invito;
- Per ciascun prodotto proposto:
- Descrizione prodotto offerto marca, modello/nome commerciale, codice e confezionamento dei prodotti offerti;
- Nome del produttore e il codice REF
- Marcatura CE e codice CND
- Numero identificativo di iscrizione al Repertorio per i prodotti di cui alla Direttiva 93/42/CEE
- Prezzo per singola confezione proposta;
- Costo a test/determinazione, Iva esclusa, onnicomprensivo del costo dei reagenti, consumabili, service dello strumento, di tutti i costi necessari per la fornitura, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico e di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto, come richiesto nel capitolato tecnico.
- importo complessivo della fornitura Iva esclusa espresso in cifre ed in lettere, in caso di discordanza si terrà valido quello espresso in lettere.
- aliquota Iva.

Servizio Provveditorato - U.O.S. Economato - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520725 - 0935/520128 - fax 0935/520340 - 520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel-0935/520711--0935/520345--Fax-0935/520340-520345

Si precisa che la strumentazione dovrà essere fornita in service gratuito e, che pertanto, non sarà dovuto alcun canone né per il noleggio né per l'assistenza tecnica.

L'offerta deve essere firmata, a pena d'esclusione, dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta 1 documentazione amministrativa.

Saranno escluse dalla gara le offerte il cui importo complessivo sia superiore o uguale al prezzo a base di gara indicato nel Capitolato tecnico.

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno _____ alle ore 11.00, presso i locali dell'ASP di Enna, Servizio Provveditorato, siti in Viale A. Diaz n. 7/9, di Enna.

Il Presidente di Gara, alla presenza dei testimoni ed assistito da un segretario verbalizzate, procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti e all'ammissione alla gara delle ditte la cui documentazione prodotta è ritenuta conforme a quella richiesta con la presente lettera-invito capitolato.

Successivamente si procederà ad inviare al Sanitario richiedente la documentazione tecnica per le valutazioni di competenza in seduta riservata. Qualora il Sanitario lo ritenga necessario potrà acquisire, a chiarimento, della documentazione presentata, ulteriore documentazione o eventuale campionatura.

Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le Ditte concorrenti che non forniranno l'ulteriore documentazione o la campionatura richiesta.

Espletata questa fase si procederà a comunicare a tutte le Ditte partecipanti alla gara il giorno fissato per la apertura delle offerte economiche e ad individuare la ditta migliore offerente secondo il criterio del prezzo più basso (art.82 del D.Lgs 163/06) in relazione al numero dei test proposti.

Individuata la migliore offerente l'Azienda può trattare con essa per eventuali ulteriori migliorie, dandone comunicazione sul sito web e/o alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare alcuna pretesa al riguardo o di non procedere all'affidamento a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.

Il Presidente di gara ha la facoltà insindacabile di sospendere la seduta di gara o di prorogarne la data. L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace con determina dirigenziale dopo l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art.38 D.Lgs 163/06.

Adempimenti post aggiudicazione

La gara avrà una durata triennale a condizione che, per gli anni successivi al primo, il progetto sarà finanziato dall'Assessorato Regionale Sanità.

La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di contratto nei modi e nelle forme di legge da registrarsi solamente in caso d'uso.

La ditta aggiudicataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, pari al 10% dell'importo contrattuale, prestata con le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs 163/06.

Servizio Provveditorato - U.O.S. Economato - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520725 - 0935/520128 - fax 0935/520340 -520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel. 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 - 520345

Si significa che la fornitura sarà regolata dalle seguenti condizioni che si intenderanno accettate con l'invio del suddetto preventivo:

1. I quantitativi della fornitura indicati nella presente lettera d'invito sono approssimativi e, pertanto possono subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno.
2. I prodotti dovranno essere consegnati presso i Magazzini Farmacia dell'Azienda, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine. Qualora la Ditta non abbia la disponibilità dei prodotti, dovrà segnalarlo entro 3 giorni dall'ordine al Servizio di Farmacia dell'Azienda.
3. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna, dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità. Non verranno accettati dal Magazzino Farmacia prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).
4. pagamento entro 60 gg. dalla ricezione della fattura semprechè non si verificano contestazioni.
5. validità offerta per un periodo non inferiore a 120 giorni dalla data di arrivo del preventivo.

Nel caso in cui la ditta non evada la richiesta entro i termini fissati o non completi entro il termine la fornitura, sarà applicata una penale pari all'1% del valore della merce non consegnata per ogni giorno, restando in facoltà dell'Azienda di acquistare le merci non fornite, nei quantitativi occorrenti, al libero mercato addebitando ogni eventuale spesa alla ditta inadempiente, nonché dichiarare risolto il rapporto dopo tre inadempienze, anche non consecutive, oltre al diritto per eventuali danni. L'Azienda avrà lo stesso diritto nel caso in cui la merce fornita venga rifiutata perché non rispondente ai requisiti richiesti.

pagamento: entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti. Si precisa che i prezzi offerti si potranno utilizzare per ulteriori richieste che dovessero presentarsi

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.
- i) In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Servizio Provveditorato - U.O.S. Economato - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520725 - 0935/520128 - fax 0935/520340 - 520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel. 0935/520711 - 0935/520345 - Fax. 0935/520340 - 520345

j) In caso di aggiudicazione di gara di bacino e/o consorziata.

Si avverte che, ai sensi dell' art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico ;
- b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il preventivo dovrà pervenire, in uno a tutta la documentazione, entro le ore 10,00 del presso il Protocollo Generale dell'ASP viale Diaz 7/9 -Enna 94100 con la seguente dicitura "**Preventivo per la fornitura in service di kit per la determinazione di HR HPV DNA di Enna -**

Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nella presente lettera d'invito e capitolato possono essere richieste al Servizio Provveditorato Tel. 0935/520711 - Fax 0935/520345 .

La ditta aggiudicataria, con l'accettazione delle condizioni della presente richiesta, si impegna espressamente ad accettare, esclusivamente, la competenza del Foro di Enna per tutte le controversie nascenti tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che non siano di competenza del Giudice Amministrativo.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
F.to (Dr. Carta F. Libera)