



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1501

DEL 18 OTT 2022

OGGETTO: Indizione procedura aperta per la fornitura in acquisto di n. 5 defibrillatori multiparametrici, di n. 1 sistema di prova da sforzo, di n. 3 aspiratori medico-chirurgici e di n. 2 monitor multiparametrici da destinare a diverse Unità Operative dell'ASP di Enna.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 690514

DEL 05/10/2022

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA
Assistente Amministrativo

Francesco Nobile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assistente Amministrativo

Dott.ssa Claudia Digeronimo

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 548/22 del 13/10/22 CE / C.P. 101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Pistone

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dott.ssa M. PILATO

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 17/10/2022

VISTA la richiesta prot. n. 27072 del 01/04/2021, con la quale il Responsabile U.O.S.D. Anestesia/ T.I. del P.O. "Basilotta" di Nicosia ha richiesto la fornitura di n. 2 aspiratori medico-chirurgici portatili da destinare alla U.O.S.D. Terapia Intensiva del P.O. "Basilotta" di Nicosia, di cui uno a completamento del carrello di emergenza della U.O. Terapia Intensiva e uno per l'Ambulatorio di Anestesia;

VISTA la richiesta prot. n. 113098 del 13/12/2021, con la quale il Responsabile dell' U.O.S.D. Medicina Nucleare del P.O. "Umberto I" di Enna e il Direttore U.O.C. Cardiologia hanno richiesto la fornitura di n. 1 sistema di prova da sforzo da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia Nucleare presso il P.O. "Umberto I" di Enna e sulla quale è stato apposto il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

VISTA la nota protocollo n. 16518 del 15/02/2022, con la quale è stata trasmessa la nota protocollo n. 16085 del 14/02/2022 (in duplice copia), corredata dal parere favorevole da parte del Direttore Sanitario Aziendale, a firma congiunta del Responsabile U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. Basilotta di Nicosia e del Direttore U.O.C. Astanteria P.O. Umberto I di Enna, anche nella qualità di Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione Aziendale, con la quale si richiede la fornitura di n. 1 defibrillatore multiparametrico bifasico manuale/semiautomatico con monitor, in quanto il defibrillatore in dotazione è in fase di dismissione, giusta verbale del Servizio di Ingegneria Clinica allegato;

CONSIDERATO che il Direttore del sopracitato Dipartimento, nella seconda copia della suddetta richiesta, ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori 2 defibrillatori aventi le medesime caratteristiche tecniche, da destinare alla nuova Struttura "EX CISS", sita in C/da Pollicarini di Pergusa (EN), per le attività di degenza in favore di pazienti affetti da COVID-19;

VISTA la richiesta prot. n. 56837 del 01/06/2022, vistata dal Capo Dipartimento, con la quale il Responsabile U.O.S.D. di Radiologia P.O. "Basilotta" di Nicosia ha richiesto la fornitura di n. 2 defibrillatori multiparametrici bifasici manuali/semiautomatici con monitor e di n. 1 aspiratore medico-chirurgico da destinare alla U.O.S.D. di Radiologia del P.O. "Basilotta" di Nicosia, in quanto la stessa risulta sprovvista a causa della dismissione dell'apparecchiatura de qua;

VISTA la richiesta prot. n. 71146 del 06/07/2022, con apposto parere favorevole del Direttore Sanitario e autorizzata dal Direttore Generale, con la quale il Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "Umberto I" di Enna ha richiesto la fornitura di n. 2 monitor multiparametrici da destinare alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "Umberto I" di Enna.

DATO ATTO:

CHE le sopracitate richieste sono state inserite nel piano degli investimenti per l'anno in corso tra le apparecchiature di bassa e media tecnologia e che la somma occorrente rientra nella disponibilità complessiva del conto di pertinenza;

CHE, per i beni da acquistare, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" Regionale, non sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni Consip;

CHE, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le PP.AA. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

CHE occorre indire idonea procedura di gara, tramite MEPA, per l'individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare la fornitura dei beni in argomento;

CHE le caratteristiche dei beni sono state fornite dai Responsabili richiedenti;

CHE sul MEPA sono stati individuati i beni di che trattasi e che considerate le diverse tipologie si ritiene opportuno articolare la gara in quattro lotti come di seguito indicati:

Lotto n.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario oltre IVA	Totale oltre IVA
1	Defibrillatore multiparametrico bifasico manuale/semiautomatico	5	€ 7.200,00	€ 36.000,00
2	Sistema di prova da sforzo	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3	Aspiratore medico-chirurgico	3	€ 525,00	€ 1.575,00
4	Monitor multiparametrico	2	€ 2.500,00	€ 5.000,00

Totale complessivo base d'asta € 54.575,00 oltre IVA

RITENUTO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di **€ 54.575,00 oltre IVA** come per legge, ritenuta congrua a seguito di indagine di mercato pubblicata sul sito internet aziendale, risulta essere la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità delle UU.OO.CC. richiedenti) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte abilitate per le categorie merceologiche in argomento, e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

L'anno duemilaventidue il giorno 18 OTT 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Nota prot. 27072 del 01/04/2021 a firma del Responsabile U.O.S.D. Anestesia/T.I. P.O. "Basilotta" di Nicosia;
- B) Nota prot. n.113098 del 13/12/2021 a firma del Responsabile dell' U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. "Umberto I" di Enna, con apposto parere del Direttore Sanitario Aziendale;
- C) Nota prot. n.16518 del 15/02/2022 a firma del Responsabile U.O.S. Pronto Soccorso P.O. "Basilotta" di Nicosia, con apposto parere del Direttore Sanitario Aziendale;

- D) Nota prot. 58318 del 07/06/2022 a firma del Responsabile dell' U.O.S.D. Radiologia P.O. "Basilotta" di Nicosia;
- E) Nota prot. 71146 del 06/07/2022 a firma del Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "Umberto I" di Enna;
- F) Lettera di invito/capitolato per avvio R.D.O. su MEPA;
- G) Patto di integrità anticorruzione;
- H) Modello autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- I) Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;
- J) Modello di offerta economica dettagliata con specifica dei prezzi praticati ad altre Aziende del SSN.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura aperta, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità delle UU.OO.CC. richiedenti), invitando tutte le ditte iscritte e abilitate per la relativa categoria merceologica, in conformità del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicare, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura dei beni descritti nella lettera d'invito/capitolato, come indicato in premessa e di seguito elencati:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario oltre IVA</i>	<i>Totale oltre IVA</i>
1	Defibrillatore multiparametrico bifasico manuale/semiautomatico	5	€ 7.200,00	€ 36.000,00
2	Sistema di prova da sforzo	1	€ 12.000,00	€ 12.000,00
3	Aspiratore medico-chirurgico	3	€ 525,00	€ 1.575,00
4	Monitor multiparametrico	2	€ 2.500,00	€ 5.000,00

Totale complessivo base d'asta € 54.575,00 oltre IVA

2. **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato tecnico e i relativi allegati.
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito Internet Aziendale.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di € 54.575,00 oltre IVA (base d'asta), o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul conto patrimoniale n. 101020501 **"Attrezzature sanitarie e scientifiche"** del

corrente bilancio, e sarà assunto con successivo provvedimento di aggiudicazione della fornitura in argomento.

5. **DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività delle Strutture richiedenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giusappa Tornabene



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 23 OTT 2022

al 06 NOV 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

- immediatamente esecutiva dal 18 OTT 2022

Enna li,


IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

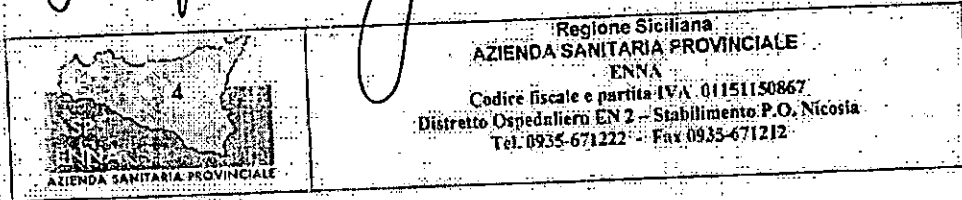**UO Anestesia / Terapia Intensiva**

Responsabile Dr. Davide Di Fabrizio

CRILI: 204FH49X033

Nicosia 01/04/2021

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario Aziendale

Al Provveditorato

Al Direttore Dipartimento Emergenza

Alla Direzione Medica di Presidio

oggetto: richiesta acquisto di n. 2 Aspiratori Chirurgici portatili per la U.O. Anestesia/Terapia Intensiva

Si richiede con carattere di urgenza, l'acquisto di n. 2 (due) Aspiratori Chirurgici portatili per:

- n. 1 a completamento del Carrello di Emergenza della U.O. Terapia Intensiva;
- n. 1 per l'ambulatorio di Anestesia, nei cui locali non vi è possibilità di attacco all'impianto di aspirazione centralizzata e dove vengono effettuate prestazioni ambulatoriali per la gestione del patrimonio venoso e procedure infiltrative per la terapia del dolore e che pertanto potrebbero richiedere in urgenza/emergenza l'utilizzo dell'elettromedicale di cui all'oggetto.

L'apparecchio deve avere i seguenti requisiti tecnici minimi:

- con alimentazione AC/DC (in dotazione) e alimentazione interna (batteria al Pb 12V/4A)
- con vuotometro e regolatore di vuoto
- autonomia 60 min.
- potenza assorbita: 4 A
- pompa a membrana
- Aspirazione Max regolabil.: 0,80 Bar - 80kPa - 600mmhg
- Flusso di aria libero: 36l/min
- funzionamento: continuo
- dimensioni: 35 cm +/-2 x 20 cm +/-2 x 18 cm +/-2.

Con i seguenti accessori inclusi:

- alimentatore universale AC/DC
- alimentatore universale AC/DC con presa Schuko
- set tubi silicone 8x14 mm (autoclavabili) + raccordo conico (diametro 10-11-12 mm)
- sonda aspirazione CH20

In attesa di Vs. sollecitato riscontro, si porgono cordiali saluti.

Responsabile U.O. Anestesia/T.I.
P.O. Casalpinta - Nicosia
Davide Di Fabrizio

Bianchi



Distretto Enna 1

U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC
 Presidio Ospedalieri "Umberto I" di Enna



Distretto Enna 1

U.O.S.D. MEDICINA NUCLEARE
 Presidio Ospedalieri "Umberto I" di Enna

despune fare favore

[Handwritten signature]

AL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO
ALLA DIREZIONE SANITARIA

ENNA 13/12/2021

OGGETTO: ACQUISTO SISTEMA PROVA DA SFORZO

L'ambulatorio di cardiologia nucleare è costantemente impegnato nella diagnostica cardiologica in favore dei pazienti cardiopatici grazie alla collaborazione tra i medici della Medicina Nucleare ed i medici della Cardiologia. Il numero di pazienti coinvolti è di circa 250/ anno con le relative circa 500 prestazioni e il numero tende a salire. Le apparecchiature di diagnostica cardiologica a disposizione necessitano, ormai, di sempre più frequenti interventi manutentivi e la loro vetustà non garantisce più prestazioni di qualità ottimale.

SI CHIEDE PERTANTO

L'acquisto urgente di un sistema di prova da sforzo così composto:

Il sistema dovrà essere dotato di: Personal computer di ultima generazione, Stampante Laser a colori e Monitor a colori LCD da almeno 22" ECG a 12 derivazioni con trasmissione telemetrica in alta definizione e in radiofrequenza (no Bluetooth) del segnale ECG secondo le normative ministeriali, protetto da disturbi ambientali (rete cellulare, wireless, bluetooth ecc) e con ricerca automatica per canale di trasmissione ideale. Deve consentire visualizzazione di tutte le derivazioni simultaneamente, memorizzazione e stampa di tutto il test, memorizzazione e stampa automatica di eventi segnalati dall'operatore e fenomeni aritmici rilevati automaticamente. Analisi del tratto ST e calcolo dei complessi mediani. Dovrà essere dotato delle seguenti funzioni :

- ST, Pendenza del tratto ST, HR, Sys/Dias (inserimento manuale) , Doppio Prodotto.

- Full Disclosure
- Possibilità di congelare una o più tracce a video
- Analisi delle Aritmie anche durante il test
- Stime dei METS
- Riconoscimento automatico dei battiti ventricolari e sopraventricolari e prematuri
- Punto J in tempo reale e da memoria • Complessi medi visualizzabili in tempo reale in comparazione con quelli basali
- Filtri digitali per correzione linea di base
- Possibilità di costruire trend dei vari parametri.
- Il sistema deve essere interfacciabile con Treadmil in dotazione al reparto (Medisoft 870A).
- Stampa personalizzabile dei tracciati ECG e del Report finale su carta comune o millimetrata
- Il Software deve essere implementabile (in opzione da quotare) ad Ergospirometria, in grado di gestire contemporaneamente le prove , generando un unico report ed archivio. Il sistema dovrà essere in grado di effettuare : Misura del dispendio energetico a riposo e sotto sforzo Misura consumo di O2 e produzione di CO2. Sensore di Ossigeno di Tipo Paramagnetico (non usurabile) Esecuzione test di funzionalità respiratoria semplice (FVC, SVC, MVV e FVC Post) Sw di gestione in lingua italiana con un unico database Misura della gittata cardiaca con metodo cardiografia impedenziometrica SM-ICG (Opzione Futura). Funzione Post Test Edit che deve permettere di aggiustare/filtrare i risultati, calcolare le soglie (AT, RCP), VO2 max, curva ed intersezione VE/VCO2 e altri parametri necessari per l'interpretazione.
 - Cicloergometro max 900 W interfacciabile col sistema
- Il sistema dovrà inoltre essere dotato di carrello dedicato per l'alloggio di tutti i suoi componenti, dovrà essere dotato di ruote frenanti per un facile trasporto e dotato di un trasformatore di isolamento per renderlo idoneo all'uso medicale.

Costo presunto circa 12000 euro + IVA

Il Direttore dell'UOC Cardiologia

Il Responsabile dell'UOSD Medicina nucleare

ASL SANITARIA PROVINCIALE
 OSPEDALIERO UMBERTO I - ENNA
 SPERIMENTO ENNA 1
 U.O.S.D. Medicina Nucleare
 Dott.ssa SERENA CASTORINI
 O.M. CT 13562

Man

Nun

REGIONE SICILIANA



U.O.S. Pronto Soccorso - P.O. "C. Basilotta"

Via San Giovanni - 94014 - Nicosia

Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

Telefono 0935/671406 - 646300 - fax 0935/671228

e.mail: prontosoecorso.basilotta@asp.enna.it

Nicosia li, 14/02/2022

Dr.ssa Claudia Melilli

AL DIRETTORE DEL DEA
ENNA

IL DIRETTORE
DEA ENNA

OGGETTO: RICHIESTA ACQUISTO URGENTE DEFIBRILLATORE.

A seguito nota da parte della ditta elettromedicale, di cui si allega copia, con la quale ci viene proposta la dismissione del defibrillatore Lifepak 12 inv. 28610, in quanto impossibilitata a ripararlo per mancanza di parti di ricambio, si richiede alla S.V. l'acquisto urgente del seguente defibrillatore:

N. 1 Defibrillatore multiparametrico bifasico manuale/semiautomatico con monitor conforme alle normative CE avente le seguenti caratteristiche:

- Costruzione resistente agli urti, alle vibrazioni ed impermeabile e dotato di maniglia per il trasporto;
- Monitor a colori di almeno 7", con visualizzazione di almeno tre tracce (ECG, SPO2, CO2) e visualizzazione di dati alfanumerici quali: frequenza cardiaca, polso, NIBP, respiro, SPO2, ampiezza ECG, derivazione ECG, energia caricata, frequenza;
- Monitor/defibrillatore bifasico esterno utilizzabile in modalità sincronizzata e non, manuale e semiautomatica (max 360J);
- La stampante integrata deve permettere la riproduzione delle 12 derivazioni elettrocardiografiche e dei parametri vitali monitorizzati in modo chiaro e completo (ampia larghezza della carta, 100 mm).
- Il monitor defibrillatore deve essere dotato dei seguenti moduli per monitorizzare i seguenti parametri vitali:
 - ECG 12 derivazioni con preview del tracciato;
 - Pulsiossimetria (con affidabilità anche su paziente neonatale);
 - Pressione non invasiva NIBP;
 - Modulo pace maker con modalità fix, demand e overdrive;
 - Modulo CO2 (con possibilità d'utilizzo anche su paziente non intubato);
 - Modulo Temperatura;
- Per l'utilizzo in modalità manuale deve possedere comandi di carica e scarica, sulle piastre rigide con possibilità di rilevamento del tracciato dalle piastre stesse;
- Come defibrillatore semiautomatico (DAE) deve essere previsto l'uso del veloce protocollo 1, 2, 3;

[Faint stamp and illegible text]

REGIONE SICILIANA



U. O. S. Pronto Soccorso - P. O. "C. Basilotta"

Via San Giovanni - 94014 - Nicosia

Responsabile: Dr. ssa Claudia Melilli

Telefono: 0935/671406 - 646300 / fax: 0935/671228

e-mail: prontosoccorso.basilotta@asp.enna.it

- Il defibrillatore deve funzionare con batterie ricaricabili (da fornire in dotazione - tempo di ricarica 1-2 ore max), o collegato alla corrente elettrica;
- L'autonomia delle batterie deve essere superiore alle 60 scariche a massimo voltaggio;
- Deve essere prevista la possibilità di rilevamento del pacemaker;
- Possibilità di espansione a collegamento con sistemi esterni via GSM/GPRS; Bluetooth;
- Possibilità di utilizzare il dispositivo a temperature molto basse o molto alte (da -20° a +55°);
- Dotazione di n. 10 rotoli di carta per stampante integrata;
- Dotazione di tutti i cavi completi per il funzionamento, preferibilmente preconnessi, per monitorizzare i parametri vitali (ECG 12 derivazioni, SPO2 adulto, pediatrico, NBPI con bracciali adulto, pediatrico, obeso);
- Dotazione di connettore per piastre adesive;
- Dotazione di 5 piastre adesive pediatriche;
- Dotazione di 10 piastre adesive adulti;
- Dotazione di cavo e sensore adulti riutilizzabile per SPO2 adulto, pediatrico;
- Deve essere previsto test di verifica scarica incorporato con stampa del risultato;
- Lo stato di carica delle batterie deve essere costantemente visibile nel monitor.
- All'avvio e durante l'utilizzo, lo strumento, deve effettuare una serie di auto-test che consentano di rilevare qualsiasi malfunzionamento o condizione anomala che possa verificarsi ed influire sulla sicurezza di utilizzo dell'apparecchio.
- Comandi vocali per modalità semiautomatica;
- Deve essere previsto un sistema di stampa e memorizzazione di elevata capacità in grado di conservare rapporti di defibrillazione ed archiviazione di tracciati elettrocardiografici;
- Controllo impedenza piastre;
- Energia configurabile dall'utente;
- Segnalazione allarmi per parametri utilizzabili; di funzionalità dello strumento e onda elettrocardiografica anomala;
- Stampante su carta degli eventi registrati.
- Dimensioni: piccolo e compatto per posizionamento su carrello d'emergenza;
- Il defibrillatore deve rispondere agli standard di sicurezza e deve essere conforme alle normative CE.

U. O. S. di Pronto Soccorso
Responsabile: Dr. ssa Claudia Melilli

A.S.P. - ENNA
Responsabile P.S.
Dr. ssa Claudia E. Melilli
Matricola - 2410
Ordine Medici - CT 11968

*all'uff. fascicolo
di archivio separato
con esposto di infertilità
Yley*

A.S.P. ENNA
Direttore MCAU - ENNA
Dr. Luigi Renato Valenti
Matricola - 3406
Ordine Medici - EN 1063

2
Ben

REGIONE SICILIANA



U.O.S. Pronto Soccorso - P.O. "C. Basilotta"

Via San Giovanni - 94014 - Nicosia

Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

Telefono 0935/671406 - 646300 - fax 0935/671228

e-mail: prontosoccorso.basilotta@asp.enna.it

- Il defibrillatore deve funzionare con batterie ricaricabili (da fornire in dotazione - tempo di ricarica 1-2 ore max), o collegato alla corrente elettrica;
- L'autonomia delle batterie deve essere superiore alle 60 scariche a massimo voltaggio;
- Deve essere prevista la possibilità di rilevamento del pacemaker;
- Possibilità di espansione a collegamento con sistemi esterni via GSM/GPRS; Bluetooth;
- Possibilità di utilizzare il dispositivo a temperature molto basse o molto alte (da -20° a +55°);
- Dotazione di n. 10 rotoli di carta per stampante integrata;
- Dotazione di tutti i cavi completi per il funzionamento, preferibilmente preconnessi, per monitorizzare i parametri vitali (ECG 12 derivazioni, SPO2 adulto, pediatrico, NBPI con bracciali adulto, pediatrico, obeso);
- Dotazione di connettore per piastre adesive;
- Dotazione di 5 piastre adesive pediatriche;
- Dotazione di 10 piastre adesive adulti;
- Dotazione di cavo e sensore adulti riutilizzabile per SPO2 adulto, pediatrico;
- Deve essere previsto test di verifica scarica incorporato con stampa del risultato;
- Lo stato di carica delle batterie deve essere costantemente visibile nel monitor.
- All'avvio e durante l'utilizzo, lo strumento, deve effettuare una serie di auto-test che consentono di rilevare qualsiasi malfunzionamento o condizione anomala che possa verificarsi ed influire sulla sicurezza di utilizzo dell'apparecchio.
- Comandi vocali per modalità semiautomatica;
- Deve essere previsto un sistema di stampa e memorizzazione di elevata capacità in grado di conservare rapporti di defibrillazione ed archiviazione di tracciati elettrocardiografici;
- Controllo impedenza piastre;
- Energia configurabile dall'utente;
- Segnalazione allarmi per parametri utilizzabili; di funzionalità dello strumento e onda elettrocardiografica anomala;
- Stampante su carta degli eventi registrati.
- Dimensioni: piccolo e compatto per posizionamento su carrello d'emergenza;
- Il defibrillatore deve rispondere agli standard di sicurezza e deve essere conforme alle normative CE.

U. O. S: di Pronto Soccorso
Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

A.S.P. - ENNA
Responsabile P.S.
Dr.ssa Claudia E. Melilli
Matricola - 2410
Ordine Medici - CT 11968

*In allegato al
numero n. 3.
di cui deve
essere allegata*

*DEA
Yes*

AUEGATO D. M.

REGIONE SICILIANA



UOSD Radiologia P.O. Basilotta
Via San Giovanni 94014 Nicosia

Responsabile: Dr. Francesco Paolo Castelli
Telefono: 0935/671374 e-mail: radiologia.basilotta@asp.enna.it

Al Direttore del Dipartimento dei Servizi
Dr. E. M. Di Maggio

Al Direttore Sanitario Aziendale
Dr. E. Cassarà

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa M. C. Perna

Oggetto: Acquisto n. 2 defibrillatori e n. 1 aspiratore medico-chirurgico.

Facendo seguito alla nota di rassegna inviata dalla Sig.ra Riccobene Oletta Paola Lucia in data 07/06/2022, a seguito della nota di cui in oggetto con prot. n. 0056837 del 01/06/2022, si chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, di attivare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'acquisto di quanto sopra.

Si allega alla presente la nota di cui sopra.

Totale pagine trasmesse n. 6 pagine, compresa la presente.

Certo di un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Nicosia 07.06.2022

Il Responsabile U.O.S.D. di Radiologia
Dr. Francesco Paolo Castelli

REGIONE SICILIANA



UOSD Radiologia P.O. Basilotta
Via San Giovanni 94014 Nicosia

Responsabile: Dr. Francesco Paolo Castelli
 Telefono: 0935/671374 e-mail: radiologia.basilotta@asp.enna.it

Al Responsabile U.O.C. Servizio Provveditorato

Al Responsabile U.O.S. Gestione del Patrimonio

Al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

E.p.c.

Al Responsabile U.O.S.D Direzione Medica di Presidio
 S.O. "C. Basilotta" di Nicosia

Al Responsabile U.O.S. Prog. E Man. Serv. Gen., Gest. Appalti,
 Ing. Clin. Biotecnologie ed Energy Manager
fabio.dattilo@althea-group

Oggetto: Acquisto n. 2 defibrillatori e n. 1 aspiratore medico-chirurgico.
 Alienazione n. 3 diafanoscopi.

La Scrivente U.O.S.D. di Radiologia dello Stabilimento Ospedaliero C. Basilotta di Nicosia, facendo seguito alla nota a firma dell'Ing. F. Dattilo della Direzione Tecnica Althea Italia S.p.a. prot. n.2022/0026/ASPEN del 31/05/2022 che ad ogni buon fine si allega alla presente, chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, di attivare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'acquisto di n. 2 defibrillatori e n. 1 aspiratore medico-chirurgico e per l'alienazione di n. 3 diafanoscopi.

In particolare la richiesta per l'acquisto delle apparecchiature di cui in oggetto nasce a seguito della relazione di cui sopra a firma dell'Ing. F. Dattilo la quale afferma la "obsolescenza delle apparecchiature" delle quali si richiede l'acquisto pertanto, tale acquisto appare urgente, imprescindibile e non procrastinabile al fine di prevenire eventuali problematiche legate alla vetustità delle apparecchiature che potrebbero verificarsi durante il loro uso.

Certo di un sollecito e cortese riscontro, data l'importanza dell'argomento, si porgono cordiali saluti.

Totale pagine trasmesse n. 5 compresa la presente.
 Nicosia, 01/06/2022


Il Responsabile U.O.S.D. di Radiologia
 Dr. Francesco Paolo Castelli

U...

aspe.ASP ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0071146.06-07-2022

201.4868
del 5-2-21

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 4
ENNA



U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore ff: A. RUSSO

Al Direttore Sanitario
S.O. Umberto I
Al Responsabile del Provveditorato
Enna

Oggetto: Richiesta fornitura di 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI

Con la presente si richiede la fornitura di n° 2 monitor multiparametrici, da utilizzare nella U.O.C. diretta dal sottoscritto, al fine di monitorizzare i pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia complessa nonché i pazienti ad alto rischio anestesjologico e cardiovascolare.
Si richiede che i prodotti in oggetto abbiano le seguenti caratteristiche tecniche:

- Display ad alta risoluzione
 - tracciati in tempo reale
 - rilievo parametri standard: ECG, frequenza respiratoria, SpO2, NIBP, temperatura
 - allarmi visivi e acustici
- e che siano corredati di:
- cavo per ECG
 - bracciale per NIBP
 - sonda per SpO2 per adulti con cavo
 - sensore di temperatura superficie corporea
 - cavo di alimentazione
 - batteria

Certo di una sollecita e favorevole accoglienza della presente, si porgono distinti saluti.

[Signature]
Il Direttore ff


Azienda Sanitaria Provinciale Enna
Dott. Archangelo Russo
U. di Ortopedia e Traumatologia
Cod./EN/CA/0002147247
P.zza San. Cirillo del Marzio CL220

e chi l'obliete 9/1

*Il personale
di Ortopedia e
traumatologia*

[Signature]

Seppure bene bene
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassara

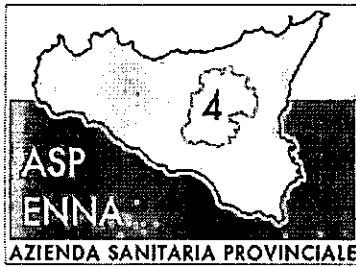

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

U.O.C. Servizio Provveditorato

Spett.li ditte

Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato:

Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it

provveditorato@pec.asp.enna.it

Responsabile U.O.S. Gare Beni:

Dott.ssa Francesca La Paglia

tel. 0935/520711

e - mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Claudia Digeronimo

tel. 0935/520131

e - mail: claudia.digeronimo@asp.enna.it

L'Incaricato dell'Istruttoria:

Francesco Nobile

tel. 0935/520344

e - mail: francesco.nobile@asp.enna.it

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura in acquisto di n. 5 defibrillatori multiparametrici, di n. 1 sistema di prova da sforzo, di n. 3 aspiratori medico-chirurgici e di n. 2 monitor multiparametrici da destinare a diverse Unità Operative dell'ASP di Enna.

Si invitano codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA per le seguenti forniture:


LOTTO 1:

- N. 5 defibrillatori multiparametrici bifasici manuali/semiautomatici con monitor da destinare: N. 1 alla U.O.S Pronto Soccorso del P.O. "C. Basilotta" di Nicosia, N. 2 alla Struttura EX CISS sito in Pergusa e N. 2 alla U.O.S.D Radiologia del P.O. "Basilotta" di Nicosia.

Importo presunto a base d'asta € 36.000,00 oltre IVA

CIG: 9286353CE9

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
 Tel. 0935/520131 - 520711

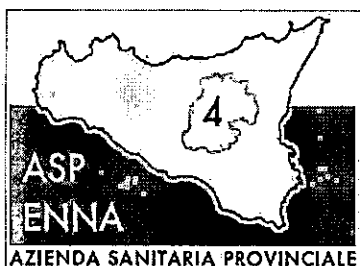

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2:

- Sistema di *prova da sforzo* da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia Nucleare presso il P.O. Umberto I di Enna.

Importo presunto a base d'asta €. 12.000,00 oltre IVA

CIG: 928636352C

LOTTO 3:

- N. 3 *aspiratori medico-chirurgici* da destinare: N.1 alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. "Basilotta" di Nicosia e N. 2 alla U.O.S.D. Anestesia/Terapia Intensiva del P.O. "Basilotta" di Nicosia.

Importo presunto a base d'asta €. 1.575,00 oltre IVA

CIG: 928638334

LOTTO 4:

- N. 2 *monitor multiparametrici* da destinare alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. "Umberto I" di Enna.

Importo presunto a base d'asta €. 5.000,00 oltre IVA

CIG: 9346502173


Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

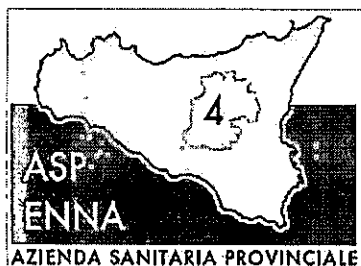

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato.
- Descrizione dell'attrezzatura offerta con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Descrizione garanzia offerta, - durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti alla procedura di gara si impegnano a fornire, ove richiesta, demo delle attrezzature offerte;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:


- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa, sconto applicato e l'importo complessivo, come da modello allegato; con ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto a ciascuna Azienda.
- Listino prezzi per eventuali forniture del relativo materiale di consumo, con indicazione della percentuale di sconto in esecuzione contrattuale nel rispetto del quinto d'obbligo.

Il prezzo dovrà comprendere: consegna, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

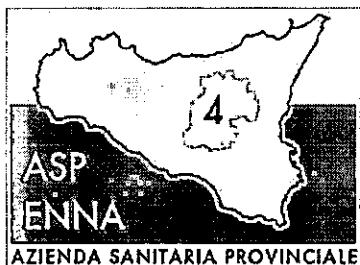

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**
- **consegna delle apparecchiature entro 20 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO): nei seguenti Magazzini Economali:**
 - **N. 3 defibrillatori presso il Magazzino Economico del P.O. "Basilotta" di Nicosia**
 - **N. 2 defibrillatori presso il Magazzino Economico del P.O. "Umberto I" di Enna**
 - **N. 1 sistema di prova da sforzo presso il Magazzino Economico del P.O. "Umberto I" di Enna.**
 - **N. 3 aspiratori medico-chirurgici presso il Magazzino Economico del P.O. "Basilotta" di Nicosia**
 - **N. 2 monitor multiparametrici presso il Magazzino Economico del P.O. "Umberto I" di Enna**

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione e asporto dell'imballaggio. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.

L'apparecchiatura deve essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione e collaudo sia dell'apparecchiatura che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali. Nell'installazione è compreso il collegamento delle apparecchiature alla rete elettrica dell'Amministrazione.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% del suddetto importo netto contrattuale. Tutti i prodotti consumabili dovranno avere al momento della consegna almeno i 3/4 della loro validità;

Penalità e danni

L'impresa avrà a disposizione per la fornitura un periodo di tempo della durata complessiva di 30 giorni successivi e continuativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte dei competenti Responsabili di Magazzino.

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti si applicheranno, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le penali in misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Il controllo sulla quantità e qualità delle attrezzature e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:


- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- l) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

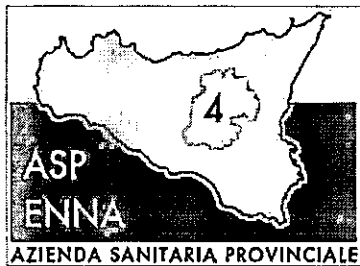

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.


La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

SEGUE ALLEGATO "A"

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

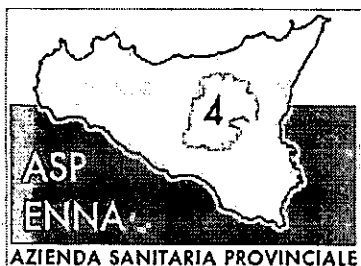

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711


ALLEGATO A

LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 5 DEFIBRILLATORI MULTIPARAMETRICI BIFASICI MANUALI/SEMIAUTOMATICI CON MONITOR DA DESTINARE: N. 1 ALLA U.O.S PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "C. BASILOTTA" DI NICOSIA, N. 2 ALLA STRUTTURA EX CISS - PERGUSA E N. 2 ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. "BASILOTTA" DI NICOSIA.

I n. 5 defibrillatori multiparametrici bifasici manuali/semiautomatici con monitor da destinare N. 1 alla U.O.S Pronto Soccorso del P.O. "C. Basilotta" di Nicosia, N. 2 alla Struttura EX CISS - Pergusa e N. 2 alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. "Basilotta" di Nicosia devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Costruzione resistente agli urti, alle vibrazioni ed impermeabile dotato di maniglia per il trasporto;
- Monitor a colori di almeno 7", con visualizzazione di almeno tre tracce (ECG, SPO2, CO2) e visualizzazione di dati alfanumerici quali: frequenza cardiaca, polso, NIBP, respiro; SPO2, ampiezza ECG, derivazione ECG, energia caricata, frequenza;
- Monitor/defibrillatore bifasico esterno utilizzabile in modalità sincronizzata e non, manuale e semiautomatica (max 360J);
- La stampante integrata deve permettere la riproduzione delle 12 derivazioni elettrocardiografiche e dei parametri vitali monitorizzati in modo chiaro e completo (ampia larghezza della carta, 100 mm);
- Il monitor defibrillatore deve essere dotato dei seguenti moduli per monitorizzare i seguenti parametri vitali:
 - ECG 12 derivazioni con preview del tracciato;
 - Pulsiossimetria (con affidabilità anche sul paziente neonatale);
 - Pressione non invasiva NIBP;
 - Modulo pace maker con modalità fax, demand e overdrive;
 - Modulo CO2 (con possibilità d'utilizzo anche su paziente non intubato)
 - Modulo temperatura
- Per l'utilizzo in modalità manuale deve possedere comandi di carica e scarica, sulle piastre rigide con possibilità di rilevamento del tracciato delle piastre stesse;
- Come defibrillatore semiautomatico (DAE) deve essere previsto l'uso del veloce protocollo 1, 2, 3;
- Il defibrillatore deve funzionare con batterie ricaricabili (da fornire in dotazione - tempo di ricarica 1-2 ore max), o collegato alla corrente elettrica;
- L'autonomia delle batterie deve essere superiore alle 60 scariche a massimo voltaggio;
- Deve essere prevista la possibilità di rilevamento del pacemaker;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

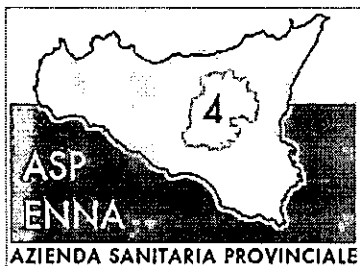

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni


Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Possibilità di espansione a collegamento con sistemi esterni via GSM/GPRS; Bluetooth;
- Possibilità di utilizzare il dispositivo a temperature molto basse o molto alte (da -20° a $+55^{\circ}$);
- Dotazione di n. 10 rotoli di carta per stampante integrata;
- Dotazione di tutti i cavi completi per il funzionamento, preferibilmente preconnessi, per monitorizzare i parametri vitali (ECG 12 derivazioni, SPO2 adulto, pediatrico, NBPI con bracciali adulto, pediatrico, obeso);
- Dotazione di connettore per piastre adesive;
- Dotazione di 5 piastre adesive pediatriche;
- Dotazione di 10 piastre adesive adulti;
- Dotazione di cavo e sensore adulti riutilizzabile per SPO2 adulto, pediatrico;
- Deve essere previsto test di verifica scarica incorporato con stampa del risultato;
- Lo stato di carica delle batterie deve essere costantemente visibile nel monitor.
- All'avvio e durante l'utilizzo, lo strumento, deve effettuare una serie di auto-test che consentono di rilevare qualsiasi malfunzionamento o condizione anomala che possa verificarsi ed influire sulla sicurezza di utilizzo dell'apparecchio.
- Comandi vocali per modalità semiautomatica;
- Deve essere previsto un sistema di stampa e memorizzazione di elevata capacità in grado di conservare rapporti di defibrillazione ed archiviazione di tracciati elettrocardiografici;
- Controllo impedenza piastre;
- Energia configurabile dall'utente;
- Segnalazione allarmi per parametri utilizzabili; di funzionalità dello strumento e onda elettrocardiografica anomala;
- Stampante su carta degli eventi registrati.
- Dimensioni: piccolo e compatto per posizionamento su carrello d'emergenza;
- Il defibrillatore deve rispondere agli standard di sicurezza e deve essere conforme alle normative CE.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 36.000,00 OLTRE IVA

CIG: 9286353CE9

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

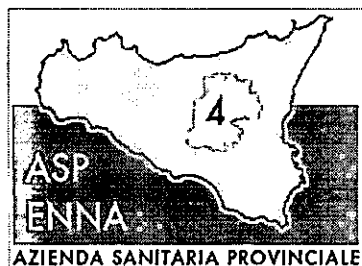

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI PROVA DA SFORZO DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA NUCLEARE DEL P.O. "UMBERTO I" DI ENNA.


Il sistema di prova da sforzo da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia Nucleare del P.O. "Umberto I" di Enna deve presentare le seguenti caratteristiche:

Il sistema dovrà essere dotato di: Personal computer di ultima generazione, Stampante Laser a colori e Monitor a colori LCD da almeno 22" ECG a 12 derivazioni con trasmissione telemetrica in alta definizione e in radiofrequenza (no Bluetooth) del segnale ECG secondo le normative ministeriali, protetto da disturbi ambientali (rete cellulare, wireless, bluetooth ecc) e con ricerca automatica per canale di trasmissione ideale. Deve consentire visualizzazione di tutte le derivazioni simultaneamente, memorizzazione e stampa di tutto il test, memorizzazione e stampa automatica di eventi segnalati dall'operatore e fenomeni aritmici rilevati automaticamente. Analisi del tratto ST e calcolo dei complessi mediani.

Dovrà essere dotato delle seguenti funzioni :

- ST, Pendenza del tratto ST, HR, Sys/Dias (inserimento manuale) , Doppio Prodotto.
- Full Disclosure
- Possibilità di congelare una o più tracce a video
- Analisi delle Aritmie anche durante il test
- Stime dei METS
- Riconoscimento automatico dei battiti ventricolari e sopraventricolari e prematuri
- Punto J in tempo reale e da memoria
- Complessi medi visualizzabili in tempo reale in comparazione con quelli basali
- Filtri digitali per correzione linea di base
- Possibilità di costruire trend dei vari parametri.
- Il sistema deve essere interfacciabile con Treadmil in dotazione al reparto (Medisoft 8704).
- Stampa personalizzabile dei tracciati ECG e del Report finale su carta comune o millimetrata
- Il Software deve essere implementabile (in opzione da quotare) ad Ergospirometria, in grado di gestire contemporaneamente le prove , generando un unico report ed archivio. Il sistema dovrà essere in grado di effettuare : Misura del dispendio energetico a riposo e sotto sforzo Misura consumo di O₂ e produzione di CO₂. Sensore di Ossigeno di Tipo Paramagnetico (non usurabile) Esecuzione test di funzionalità respiratoria semplice (FVC, SVC, MVV e FVC Post) Sw di gestione in lingua italiana con un unico database Misura della gittata cardiaca con metodo cardiografia impedenziometrica SM-ICG (Opzione Futura). Funzione Post Test Edit

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

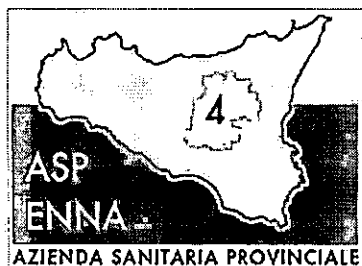

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

che deve permettere di aggiustare/filtrare i risultati, calcolare le soglie (AT, RCP), VO2 max, curva ed intersezione VE/VCO2 e altri parametri necessari per l'interpretazione.

- Cicloergometro max 900 W interfacciabile col sistema
- Il sistema dovrà inoltre essere dotato di carrello dedicato per l'alloggio di tutti i suoi componenti, dovrà essere dotato di ruote frenanti per un facile trasporto e dotato di un trasformatore di isolamento per renderlo idoneo all'uso medico.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 12.000,00 OLTRE IVA

CIG: 928636352C

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 3 ASPIRATORI MEDICO-CHIRURGICI DA DESTINARE: N. 2 ALLA U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. “BASILOTTA” DI NICOSIA E N. 1 ALLA U.O.S.D. RADIOLOGIA DEL P.O. “BASILOTTA” DI NICOSIA.


I n. 3 aspiratori medico-chirurgici da destinare N. 2 alla U.O.S.D. Terapia Intensiva del P.O. “Basilotta” di Nicosia e N. 1 alla U.O.S.D. Radiologia del P.O. “Basilotta” di Nicosia devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Alimentazione AC/DC (in dotazione) e alimentazione interna (batteria al Pb 12 V 4A);
- Vuotometro e regolatore di vuoto;
- Autonomia 60 minuti;
- Potenza assorbita: 4 A;
- Pompa a membrana;
- Aspirazione massima regolabile: -0,80 Bar – 80 kPa – 600 mmhg;
- Flusso di aria libera: 36 l/min.;
- Funzionamento continuo;
- Dimensioni: 35 cm +/-2 x 20 cm +/-2 x 18 cm +/-2;
- Alimentatore universale AC/DC;
- Alimentatore universale AC/DC con presa Schuko;
- Set tubi silicone 8 x 14 mm (autoclavabili) + raccordo conico (diametro 10-11-12 mm);
- Sonda aspirazione CH20.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 1.575,00 OLTRE IVA

CIG: 9286380334

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

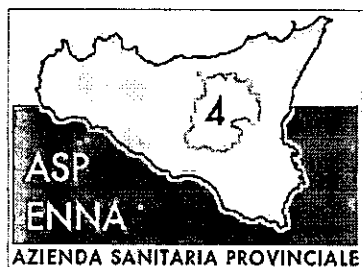

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 2 MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE ALLA U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. “UMBERTO I” DI ENNA.

I n. 2 monitor multiparametrici da destinare alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Umberto I” di Enna devono presentare le seguenti caratteristiche:

- display ad alta risoluzione
- tracciati in tempo reale
- rilievo parametri standard: ECG, frequenza respiratoria, SpO2, NIBP, temperatura
- allarmi visivi e acustici

e che siano corredati di:

- cavo per ECG
- bracciale per NIBP
- sonda per SpO2 per adulti con cavo
- sensore di temperatura superficie corporea
- cavo di alimentazione
- batteria

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 5.000,00 OLTRE IVA

CIG: 9346502173

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico

nato ail.....

residente in.....Via.....

Codice Fiscale n.....

In qualità di

dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di

Commercio di....., Partita Iva.....

in qualità di eventuale affidataria delle forniture in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice, si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara. Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dello 1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per due anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa .Maria Concetta Perna

Titolare o legale rappresentante

della Ditta.....

(timbro e firma)

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale

- se s.a.s.:

- che i soci accomandatari sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- se altro tipo di società o consorzio:

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio unico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che la ditta/società/consorzio/cooperativa _____:

partecipa come impresa singola;

in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio:

partecipa come mandataria capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

partecipa come mandante dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

1. Che la ditta _____ risulta essere iscritta alla CC.I.AA. di _____ o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione al n. _____ cod. attività _____;
2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n.575, sostituito con l'art.3 della legge 19 marzo 1990, n°55;
4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti cessati dalla carica (indicare i soggetti) nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e incarico societario);

5. Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
7. Che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è regolarmente iscritta alle seguenti posizioni dei registri:

INPS sede di _____ N. _____ dal _____

INAIL sede di _____ N. _____ dal _____


Dichiara inoltre la propria regolarità contributiva essendo in perfetto ordine con i pagamenti dei contributi dovuti e che nulla osta al rilascio del DURC.

8. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2, lett. C), del D.lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990;
11. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.80 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
12. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;
13. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;



14. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato, né si accorderà, con altri partecipanti alla gara;
15. Di avere preso visione della lettera di invito e capitolato e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;
16. Di impegnarsi ai sensi del D.P.R.445/00 ad Osservare il Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale e la Carta etica aziendale, e ad accettare, inoltre, la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto con questa A.S.P. in caso di violazione degli obblighi derivanti da tali Codici;
17. Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli, rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs. 231/02;
18. Che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato alle altre Aziende Sanitarie;
19. Che il prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al prodotto offerto (produttore/distributore/rivenditore/importatore etc);
22. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
23. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
24. Di aver preso visione dei locali e di aver valutato tutti gli elementi che possano influire sulla determinazione del prezzo
25. Di impegnarsi a fornire i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di collaudo;
26. Di accettare che il relativo pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del regolare funzionamento delle macchine e collaudo con esito positivo;

27. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
28. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:
- a) denunciare alle Autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso di esecuzione, del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) di essere a conoscenza che la violazione, debitamente accertata, dei superiori punti 1 e 2 costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del c.c.;
 - d) di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Legge regionale 15/08.
 - e) di ottemperare all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009 e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale;
29. Di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
30. In caso di RTI e consorzi d'impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
31. Il DUVRI è pari a zero;
32. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti;
33. Di accettare, nel caso di reclamo formale dell'Azienda Sanitaria Provinciale pervenuto entro 30 gg. dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce.



34. **di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito, degli allegati e delle eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte;**

Li _____

Timbro e Firma Leggibile

Am

Bm

ALL' ASP ENNA
Viale Armando Diaz, 7/9
94100 Enna EN

MODELLO PER COMUNICAZIONE EX LEGGE 136/2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI".	
G.I.G.	

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	
TELEFONO/FAX	

Il soggetto di cui sopra, ai fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con ASP di Enna sono:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	
INTESTATO A	

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	
COD. FISCALE	

N.B.: si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vi è l'obbligo di comunicarli tutti.

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che, in caso di variazione del conto corrente, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Data

.....
 (Timbro e Firma)

MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

R.d.O. n. _____

AS

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura _____

_____.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____, (prov.) _____, in via _____, n. _____, codice fiscale _____, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di *(Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente ipoteri di impegnare l'impresa)* _____ dell'impresa _____, con sede legale _____ in _____
Codice fiscale/Partita Iva _____ telefono: _____ fax: _____ e-mail: _____, pec mail _____ dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo (specificare se unitario o complessivo) offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND e Repertorio	Quantità offerta	Prezzo Unitario di listino	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo offerto	% di sconto applicato sul listino

Indicare una delle due opzioni a pena di esclusione:

B) che i prezzi unitari offerti con la presente non sono superiori a quelli praticati per analoghe forniture effettuate presso altre Aziende Sanitarie e/ o Enti Pubblici come di seguito specificato:

- Es. Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.
- Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.
- Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.

C) Dichiarazione di non aver effettuato forniture uguali a quelle oggetto della presente procedura presso altre ASP o Enti Pubblici.

Li _____

Timbro e Firma Leggibile